

DEXTHER**STOP-VIDE**

09/05

CE

Sans latex
Sans PVCStockage : Entre - 0°C / +50°C dans un lieu sec et propre, dans l'emballage d'origine.Raccordement :

Emboîter la tubulure d'aspiration du côté du crochet. La sonde d'aspiration se connecte sur la pointe effilée, compatible toutes sondes, même pédiatriques.

Instruction d'utilisation :

Déclencher l'aspiration en appuyant sur le poussoir jaune. L'ouverture est progressive selon l'effort exercé sur le poussoir.

Entretien / Maintenance :

Le stop-vide peut être rincé entre deux aspiration par aspiration d'eau stérile mais ne doit pas être nettoyé ni stérilisé.

Caractéristiques :


Totalemant étanche, en fonctionnement et au repos. Pas de consommation inutile.

Matériaux :

Corps et couvercle : polycarbonate. Poussoir Polyamide. Clapet SEBS.

Précautions :

N'aspirer que des liquides (pas de prélèvement de tissus ou d'aliments)

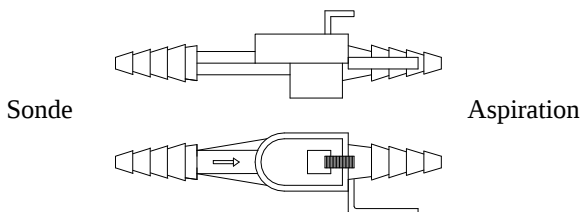

Suivant la Directive Européenne 93/42/CEE du 14 Juin 93, tout incident doit être immédiatement signalé à DEXTHER.

SOCIETE DEXTHER

35 Allée des Platanes

77100 MEAUX

Tél : 01 60 41 01 50 Fax : 01 60 41 01 51

dexther-contact@orange.fr**DEXTHER****STOP-VIDE**

09/05

CE

Sans latex
Sans PVCStockage : Entre - 0°C / +50°C dans un lieu sec et propre, dans l'emballage d'origine.Raccordement :

Emboîter la tubulure d'aspiration du côté du crochet. La sonde d'aspiration se connecte sur la pointe effilée, compatible toutes sondes, même pédiatriques.

Instruction d'utilisation :

Déclencher l'aspiration en appuyant sur le poussoir jaune. L'ouverture est progressive selon l'effort exercé sur le poussoir.

Entretien / Maintenance :

Le stop-vide peut être rincé entre deux aspiration par aspiration d'eau stérile mais ne doit pas être nettoyé ni stérilisé.

Caractéristiques :


Totalemant étanche, en fonctionnement et au repos. Pas de consommation inutile.

Matériaux :

Corps et couvercle : polycarbonate. Poussoir Polyamide. Clapet SEBS.

Précautions :

N'aspirer que des liquides (pas de prélèvement de tissus ou d'aliments)

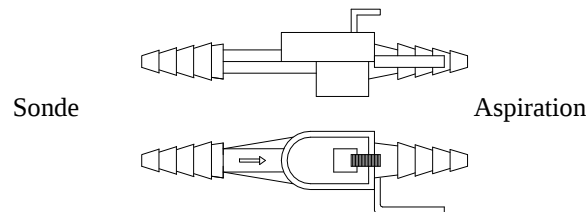

Suivant la Directive Européenne 93/42/CEE du 14 Juin 93, tout incident doit être immédiatement signalé à DEXTHER.

SOCIETE DEXTHER

35 Allée des Platanes

77100 MEAUX

Tél : 01 60 41 01 50 Fax : 01 60 41 01 51

dexther-contact@orange.fr**DEXTHER****STOP-VIDE**

09/05

CE

Sans latex
Sans PVCStockage : Entre - 0°C / +50°C dans un lieu sec et propre, dans l'emballage d'origine.Raccordement :

Emboîter la tubulure d'aspiration du côté du crochet. La sonde d'aspiration se connecte sur la pointe effilée, compatible toutes sondes, même pédiatriques.

Instruction d'utilisation :

Déclencher l'aspiration en appuyant sur le poussoir jaune. L'ouverture est progressive selon l'effort exercé sur le poussoir.

Entretien / Maintenance :

Le stop-vide peut être rincé entre deux aspiration par aspiration d'eau stérile mais ne doit pas être nettoyé ni stérilisé.

Caractéristiques :


Totalemant étanche, en fonctionnement et au repos. Pas de consommation inutile.

Matériaux :

Corps et couvercle : polycarbonate. Poussoir Polyamide. Clapet SEBS.

Précautions :

N'aspirer que des liquides (pas de prélèvement de tissus ou d'aliments)

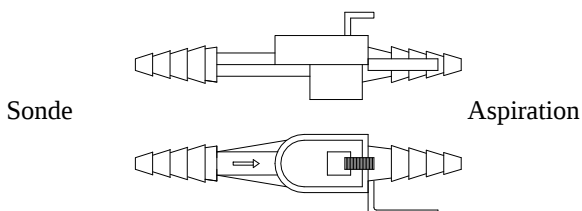

Suivant la Directive Européenne 93/42/CEE du 14 Juin 93, tout incident doit être immédiatement signalé à DEXTHER.

SOCIETE DEXTHER

35 Allée des Platanes

77100 MEAUX

Tél : 01 60 41 01 50 Fax : 01 60 41 01 51

dexther-contact@orange.fr**DEXTHER****STOP-VIDE**

09/05

CE

Sans latex
Sans PVCStockage : Entre - 0°C / +50°C dans un lieu sec et propre, dans l'emballage d'origine.Raccordement :

Emboîter la tubulure d'aspiration du côté du crochet. La sonde d'aspiration se connecte sur la pointe effilée, compatible toutes sondes, même pédiatriques.

Instruction d'utilisation :

Déclencher l'aspiration en appuyant sur le poussoir jaune. L'ouverture est progressive selon l'effort exercé sur le poussoir.

Entretien / Maintenance :

Le stop-vide peut être rincé entre deux aspiration par aspiration d'eau stérile mais ne doit pas être nettoyé ni stérilisé.

Caractéristiques :


Totalemant étanche, en fonctionnement et au repos. Pas de consommation inutile.

Matériaux :

Corps et couvercle : polycarbonate. Poussoir Polyamide. Clapet SEBS.

Précautions :

N'aspirer que des liquides (pas de prélèvement de tissus ou d'aliments)

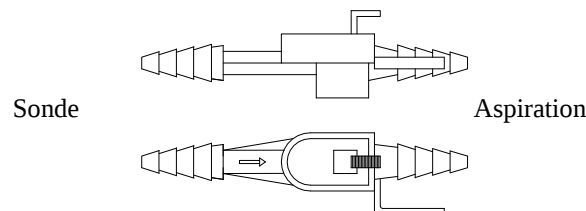

Suivant la Directive Européenne 93/42/CEE du 14 Juin 93, tout incident doit être immédiatement signalé à DEXTHER.

SOCIETE DEXTHER

35 Allée des Platanes

77100 MEAUX

Tél : 01 60 41 01 50 Fax : 01 60 41 01 51

dexther-contact@orange.fr